GUIDA RAPIDA

IL FISSATORE RADIOTRASPARENTE PER POLSO

ORTHOFIX®

Consultare le istruzioni per l'uso PQWRI del prodotto, le istruzioni per l'uso PQSCR dello strumentario correlato e dei dispositivi impiantabili Orthofix e le istruzioni per l'uso PQRMD dei dispositivi medicali riutilizzabili per le istruzioni su come utilizzare il prodotto.

INSERIMENTO DELLE VITI METACARPALI

- Applicare il fissatore lateralmente sul piano frontale o ad angolo di circa 45 gradi rispetto al piano frontale. Usare un laccio emostatico. Inserire per prima la vite metacarpale prossimale. Effettuare con il bisturi un'incisione longitudinale vicino alla base dell'osso, sulla prominenza del tubercolo del secondo metacarpo, ed eseguire la dissezione dei tessuti molli fino all'osso. Rimuovere la guida filettata dalla mascherina e posizionare l'estremità della mascherina guida vicino alla base dell'osso, sulla prominenza del tubercolo e in corrispondenza all'asse centrale. Inserire un guida perforatore nella mascherina guida e perforare l'osso con un perforatore da 2.7mm.

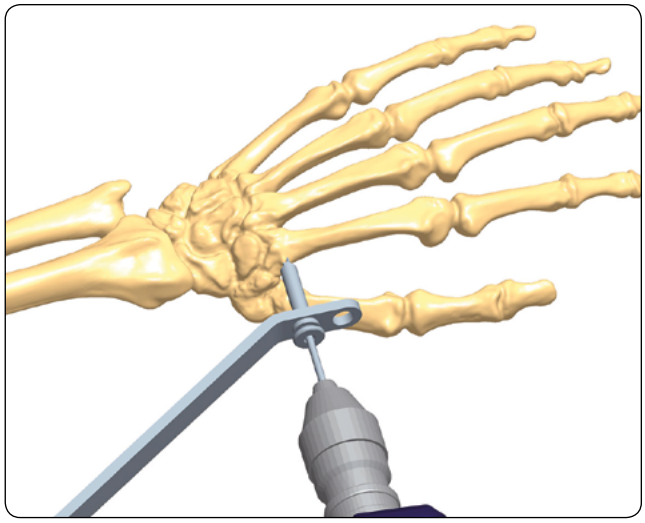

ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde evitare di danneggiare i tessuti molli.

- Rimuovere il guidaperforatore e inserire una vite da 70/20mm usando una chiave a T.

  Soltanto 1-2mm della punta della vite devono penetrare nella seconda corticale per evitare il rischio di danneggiare i tessuti molli. se verranno estratte.

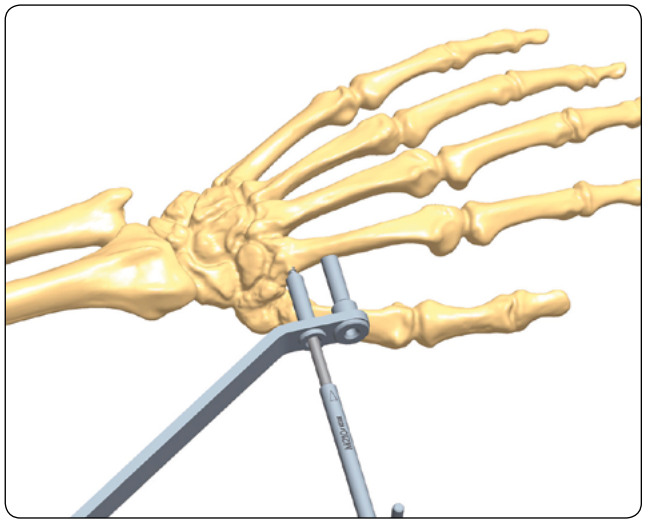

ATTENZIONE: non penetrare eccessivamente nella seconda corticale con qualsiasi tipo di vite, onde evitare di danneggiare i tessuti molli.

PRECAUZIONE: qualsiasi tentativo di estrarre una vite conica una volta inserita potrebbe causarne l'allentamento.

- Inserire completamente il guidavite filettato nella mascherina per vite, posizionarlo nel centro dell'asse dell'osso e ripetere la procedura sopra descritta per la vite metacarpale distale.

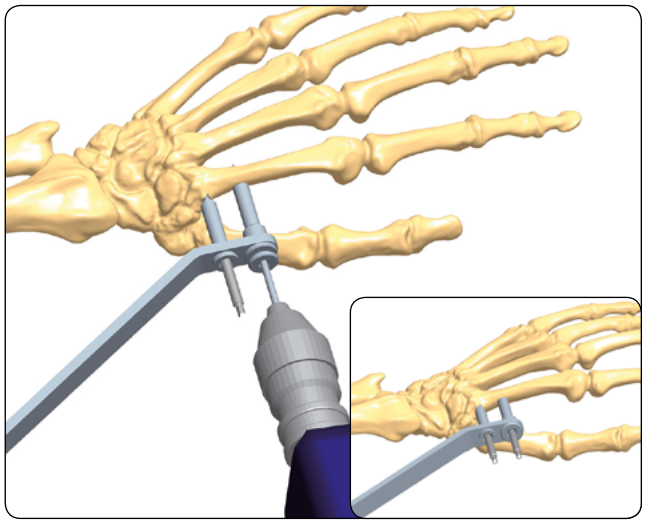

INSERIMENTO DELLE VITI RADIALI

- Inserire le viti radiali usando un approccio a cielo aperto. Montare provvisoriamente il fissatore sulle viti distali e contrassegnare sulla cute la posizione delle viti prossimali. Verificare che il corpo del fissatore sia parzialmente aperto, per consentire la distrazione o la compressione intra-operatoria della frattura. Eseguire un'incisione di 3 cm ed esporre l'osso mediante dissezione dei tessuti con forbice a punte smusse, al fine di evitare ogni lesione al ramo superficiale del nervo radiale. Inserire due viti radiali da 70/20 usando la stessa tecnica sopra descritta.

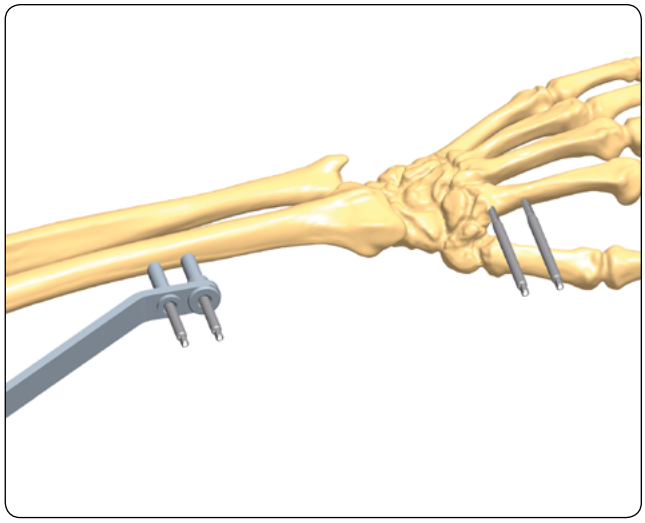

- Posizionare il fissatore sopra le viti con gli eccentrici e il grano di bloccaggio del corpo centrale allentati, assicurandosi che il grano di bloccaggio del corpo centrale non si trovi sopra la sede della frattura in quanto non è radiotrasparente. Stringere le viti di bloccaggio del coperchio morsetto con la chiave esagonale da 4mm. Ridurre la frattura e stringere gli eccentrici e il grano di bloccaggio del corpo centrale con la chiave esagonale da 4mm.

  Stringere gli eccentrici soltanto in senso orario, come indicato dalla freccia sul morsetto del fissatore.

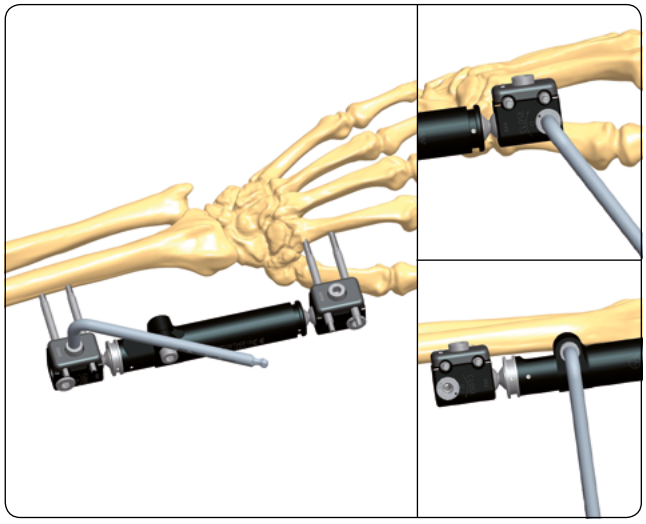

- Quando si utilizza l'unità di compressione-distrazione, individuare i morsetti nei fori sul corpo del fissatore e serrare le due viti di arresto. Per ottenere una compressione o una distrazione controllata, allentare il dado di bloccaggio del corpo centrale e ruotare l'elemento centrale dell'unità di compressione-distrazione. Una volta effettuata la procedura, serrare il dado di bloccaggio del corpo centrale e rimuovere l'unità di compressione-distrazione.

  Prima che il paziente esca dalla sala operatoria, controllare l'entità della distrazione dell'articolazione del polso mediante raggi X, per verificare che l'articolazione non sia sottoposta ad un'eccessiva distrazione.

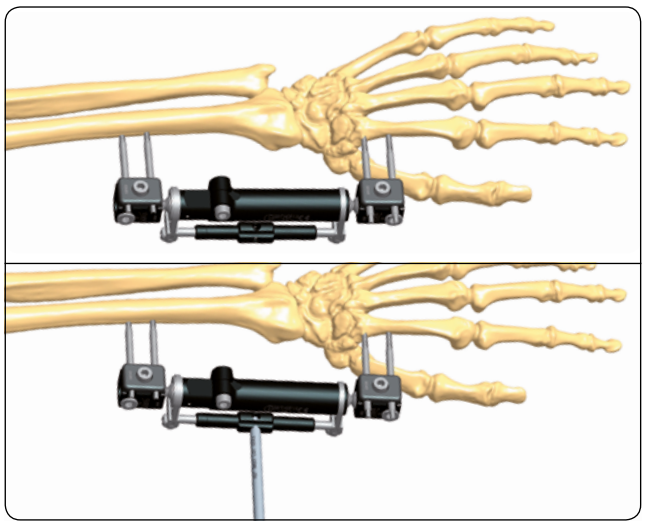

PRECAUZIONE: durante e dopo l'inserimento dei dispositivi, verificarne il corretto posizionamento con l'ausilio della scopia ad amplificazione di brillanza.

Le istruzioni elettroniche per l'uso sono disponibili sul sito Web
http://ifu.orthofix.it

Istruzioni elettroniche per l'uso - Requisiti minimi per la consultazione:
- Connessione Internet (56 Kbit/s)
- Dispositivo in grado di visualizzare file PDF (ISO/IEC 32000-1)
- Spazio su disco: 50 MB

È possibile richiedere una copia cartacea gratuita all'assistenza clienti
(consegna entro 7 giorni): tel.: +39 045 6719301, fax: +39 045 6719370
e-mail: customerservice@orthofix.it

Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123

Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del dispositivo ai medici o su prescrizione medica. L'utilizzo della procedura chirurgica corretta è responsabilità dell'operatore sanitario. Le tecniche operatorie descritte sono da intendersi esclusivamente come linee guida a scopo informativo. Ogni chirurgo deve valutare l'appropriatezza di una tecnica in base alla propria formazione medica e alla propria esperienza in ambito medico. Per informazioni complete o indicazioni per l'uso, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e informazioni sulle reazioni avverse e sulla sterilizzazione visitare il sito Web www.Orthofix.com/IFU.

ORTHOFIX®

www.orthofix.com

PG 150 I1 GA 05/21 (0418426)